<アキュチェック ST メーターの操作方法>

※穿刺器具は個人使用の製品のため、**絶対に複数の人で使いまわさないでください。**
※2本目以降のランセット(針)をご使用の際は、ご使用前に必ず手で針交換レバーをスライドさせて新しい針に換えてください。**針は自動的には換わりません。**

ACCU-CHEK® ST Meter

1. 石鹸を使って、流水で穿刺部位をよく洗い、じゅうぶんに乾かす

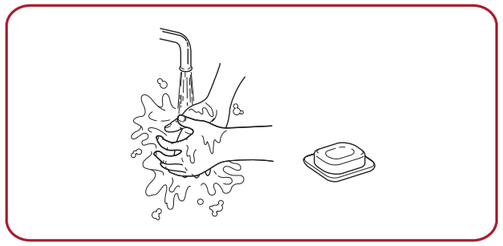

2. ランセットの針をセットする

ランセットドラムの1本目を使用する場合は・・・

本体キャップを外す

ランセットドラム(針)をセットする

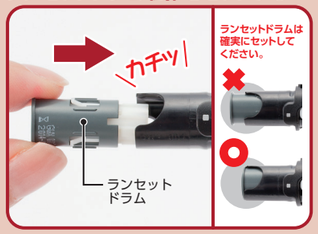

本体キャップをはめる

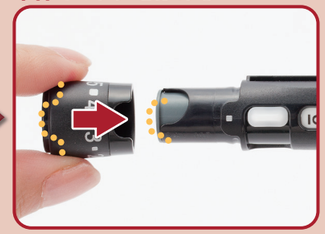

2本目以降の場合は・・・

針交換レバーをスライドさせて新しいランセットをセットする

3. 深さを調節する

4. 試験紙を1枚取り出し、すぐ閉める

5. 試験紙をセットする

6. 画面に試験紙と血液マークが表示されたことを確認する

7. 穿刺する

8. 血液をつける

9. 結果を確認する

10. 試験紙のあとかたづけ

血液のつけ方

血液のつけ方
血液は先端からつけてください。



血液吸引部の黄色い部分がすべて赤くなるまで吸引させてください。

ランセットドラムの廃棄方法

表示窓の数字が「1」になったら…

ここを持って引っ張ります。

穿刺器具本体のキャップを外し、ランセットドラムを引っ張り、外します。

使用後のランセットドラムについて

ランセットドラムは穿刺器具から抜いたら再度セットできません。

使用後のランセットドラムは赤い線がでています。

使用済みの試験紙やランセットの廃棄方法については、お住まいの地区の自治体又は各医療機関等にお問い合わせください。

お問い合わせは下記の「ロシュにハロー お客様センター」へ

フリーダイヤル ロシュに ハロー
0120-642-860
24時間 365日

アキュチェックWebサイト http://www.accu-chek.jp/

ACCU-CHEK®はロシュの血糖測定関連製品の登録商標です。

血糖測定に必要なもの

■測定器：アキュチェック ST メーター

■試験紙：アキュチェック ST ストリップ

■穿刺器具：ファストクリックス

■ランセット：ファストクリックス ランセット

■アルコール綿／ティッシュペーパー／自己管理ノートなどは必要に応じてご自身でご用意ください。

＊ 穿刺器具は個人専用品です。名前を書き、他の人に貸さないようにしましょう。

電池の交換

電池マークが表示されたら、電池の交換時期です。

ST メーターに使用する電池は

CR-2032

1個です。

1 裏面電池ボックスのカバーを開ける

2 新しい電池の＋（プラス）面を上にして入れる

※カバーはカチッというまでしっかり閉める。

画面メッセージについて

表示	原因と対応
HI が表示される	**測定結果が600mg/dLを超えています。** ◇すみやかに医師の指示に従ってください。 ▲測定結果がおおよそ2,000mg/dLを上回った場合には「E-3」と表示される可能性があります。
LOが表示される	**測定結果が10mg/dLを下回っています。** ◇すみやかに医師の指示に従ってください。 ▲測定結果が極端に低い場合はごくまれに「E-1」と「試験紙マーク」が表示される可能性があります。
“E-1”と試験紙マークが表示される	**試験紙に問題が起きました。** ◇新しい試験紙をご使用ください。 **試験紙の差し込み方が間違っています。** ◇試験紙の差し込み方向を確認して入れ直してください。
“E-3”が表示される	**測定中にエラーが発生しました。** ◇新しい試験紙で測定し直してください。 **血糖値が2,000mg/dLを超えている疑いがあります。** ◇すみやかに医師の指示に従ってください。 ▲この表示が示された場合、機器・試験紙の問題によるエラーであるか、高値のためのエラーであるか判別できませんのでご注意ください。
“E-6”と試験紙マークと血液マークが表示される	**血液又はコントロール液をつけるのが早すぎました。** （血液マークが画面に表示される前に血液又はコントロール液をつけました。） ◇新しい試験紙で測定し直してください。 ▲画面に試験紙マークと血液マークが表示されるのを確認してから測定を行ってください。
“E-8”と温度計マークが表示される	**気温が測定器の許容範囲（8～44℃）外です。** ◇8～44℃の場所に移動して5分後にもう一度測定してください。 測定器を人為的に温めたり冷やしたりしないでください。
“E-9”と電池マークが表示される	**電池切れです。** ◇すぐに電池を交換してください。 **低温の環境下で電池が冷えてしまい、測定できなくなっている可能性があります。** ◇セットされている電池を一旦取り出して、指ではさむなどして温めてから再度セットしてください。繰り返し表示される場合は電池切れです。電池を交換してください。

※その他の画面メッセージについては取扱説明書をご参照ください。

日付・時刻の確認・設定

（はじめてお使いになるときや、電池を交換した際に必要です。）

日付・時刻の変更の必要がなく、設定画面を終了する場合は、電源ボタンを４秒以上押し続けてください。

通常の測定用の画面に戻ります。

〈「Set-up」表示にする〉

1 ①電源ボタンを押す
②日付・時刻と試験紙マークの表示
③電源ボタンを4秒以上押す

2 日付・時刻と「Set-up」が点滅表示される

3 現在の時刻になっているか確認し、◀▶ボタンで調整する

4 電源ボタンを押して時刻を確定する

5 続いて「分」が点滅する。同様に◀▶で調整し、電源ボタンで確定する

6 am／pmを◀▶で選択し、電源ボタンで確定する

7 月、日、年も同様に確認・設定する



8 [終了] ①電源ボタンを4秒以上押す
②試験紙マークの表示
③もう一度電源ボタンを押し電源を切る

お問い合わせは下記の「ロシュにハロー お客様センター」へ

フリーダイヤル ロシュに ハロー
0120-642-860
24時間 365日

アキュチェックWebサイト http://www.accu-chek.jp/

ACCU-CHEK®はロシュの血糖測定関連製品の登録商標です。

0 7087896 001- B