カスタマーサポートおよびサービスセンター
ロシュにハローお客様センター
フリーダイヤル：0120-642-860

最終更新日: 2022-08

ロシュＤＣジャパン株式会社
東京都港区港南1-2-70
フリーダイヤル：0120-642-860
www.accu-chek.jp

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDEおよびアキュチェックは、Roche の商標です。
The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Roche is under license.
MiniMed is a registered trademark of Medtronic, Inc.
© 2022 Roche Diabetes Care
08163138001-0822 / 09519645001-A

ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK® Guide Link

自己検査用グルコース測定器

アキュチェックガイドLink クイックスタートガイド

***Bluetooth*®技術搭載のミニメド™ポンプと使用**

Medtronic　Roche

概要

測定器：
アキュチェックガイドLink

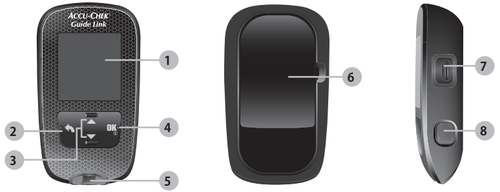

1. 画面
2. 戻るボタン
3. 上／下矢印ボタン
4. 電源／OKボタン
5. 試験紙差込口およびライト
6. 電池ボックスカバー
7. Micro-USBポート*
8. 試験紙廃棄ボタン

*USB機能はこの測定器では利用できません。

試験紙：
アキュチェックガイドストリップ

9. 試験紙容器
10. 試験紙

⚠

このクイックスタートガイドは、添付文書や取扱説明書の代わりになるものではありません。添付文書や取扱説明書には、重要な取り扱い手順やその他の情報が記載されていますので、必ずお読みください。

言語および時刻の表示形式を設定する

測定器の電源を初めてオンにすると、言語および時刻の表示形式（12時間または24時間）の選択を求めるメッセージが表示されます。

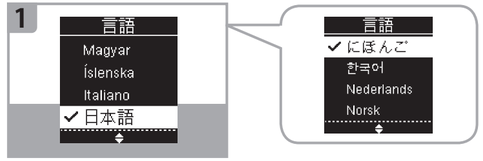

OK を長押しして測定器をオンにします。「**言語**」が表示されたら、▼または▲を押して言語を選択し、OK を押します。

ひらがなを選択することもできます。

「**時刻の表示**」が表示されます。

▼または▲を選択して「**12 時間**」（am／pm）または「**24 時間**」をハイライトします。

OK を押して確定し、「**メニュー**」に戻ります。

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.

Black

Local Print/Pack
No PMS or PE approval.
No DM code or Mannheim PN.

Approved according to SHR_SOP 04.07.08_Att A　**Category 2**

The Signature will not be printed!

LAN
IPM
PM/LAB
GD/LAY

測定器とインスリンポンプのペアリング

アキュチェックガイドLinkは、*Bluetooth*®技術搭載のミニメド™ポンプへ血糖値を自動的に送信します。

それゆえ、インスリンポンプへ血糖値を手動で入力する手間がありません。

ペアリングの手順については、ミニメド™ システムユーザーガイドを参照してください。

ご不明な点がございましたら、ロシュにハローお客様センターにお問い合わせください。

フリーダイヤル　ロシュに　ハロー
0120-642-860
24時間365日

血糖測定を行う

1



血糖測定を行う前に、流水で手を洗い、よく乾かします。

2

試験紙容器に記載の使用期限を確認します。使用期限の過ぎた試験紙は使用しないでください。

3

試験紙容器から試験紙を取り出し、フタをしっかりと閉めます。

4



試験紙の差し込み側（金属の部分）を測定器に差し込みます。

測定器の電源が自動で入ります。「**測定準備中**」が表示されます。

5

穿刺器具を使って採血します。

6



試験紙の**血液吸引部（黄色の先端部分）**に血液をつけます。血液は試験紙の先端からつけてください。

血液のつけ方

⚠ 血液は試験紙の上からではなく、先端からつけてください。

⚠ 血液吸引部（黄色の先端部分）から吸引させてください。



⚠
使用済みの試験紙およびランセットの廃棄については、お住まいの地区の自治体又は各医療機関等にお問い合わせください。

7

「**測定中**」が表示されたら、試験紙から指を離してください。

約4秒後に測定結果が表示されます。

電池を交換する

E-9のエラーメッセージが表示されたら、電池の残量が残りわずかの可能性があります。

測定器の電源を再度オンにします。**気温が低い場所にいる場合、使用環境条件の範囲内の温度の場所へ移動します。**何度か繰り返し試しても同じメッセージが表示される場合は、電池を交換してください。電池を交換してもメッセージが表示される場合、電池を取り外して電源／OKボタンを2秒以上押してから、電池を入れ直します。

測定器には、CR2032またはDL2032（メーカーによって名称が異なる場合があります）3Vコイン型リチウム電池2個を使用します。

注意

必ず予備の電池を常備してください。電池の寿命は、温度や電池の製造元などによって異なる可能性があります。

⚠

未使用および使用済みの電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。詳細については、取扱説明書を参照してください。

1

測定器背面の電池ボックスカバーのタブを矢印の方向に押し、上に持ち上げて開きます。

2

ボタンを押して古い電池を外し、取り出します。

3

新しい電池を、＋（プラス）側を上にして、黒いツメとボタンの下に入れます。電池ボックスカバーを元の向きに取り付け、カチッと音がするまで閉めます。使用済みの電池はすぐに廃棄してください。