≪ ガイドモア　データ転送方法 ≫

製品に関するお問い合わせは、「ロシュにハロー お客様センター」へ　24時間 365日　フリーダイヤル ロシュにハロー 0120-642-860

Roche

＊血糖測定を行う前に、必ず流水で手をよく洗い、十分に乾かしてください。

1. 血糖値入力エリアにカーソルを合わせます

2. 血糖値を測ります

3. 血糖値を確認後 試験紙を廃棄します（データ転送の準備が完了します）

ボタンを押して試験紙を廃棄するとデータ転送準備の完了です



画面が「転送完了」になったことを確認してください

4. ガイドモアをNFCカードリーダーにかざします

5. 血糖値の転送を確認後確定ボタンを押します

データ転送時の注意事項

⚠ 5分以上前に測定した血糖値が転送された場合「注意」メッセージが画面に表示されます

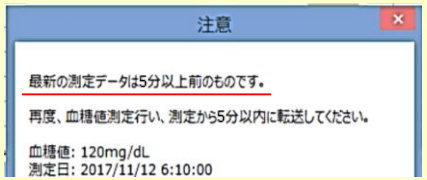

データ転送されていない可能性があります
本体の試験紙廃棄ボタンを押して再度データ転送してください

⚠ 一度転送された血糖値が再度転送された場合「注意」メッセージが画面に表示されます

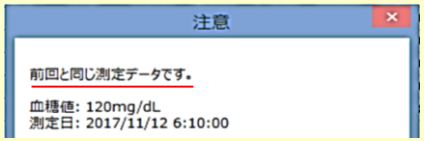

データ転送されていない可能性があります
本体の試験紙廃棄ボタンを押して再度データ転送してください

≪ ガイドモア 各部説明 ≫

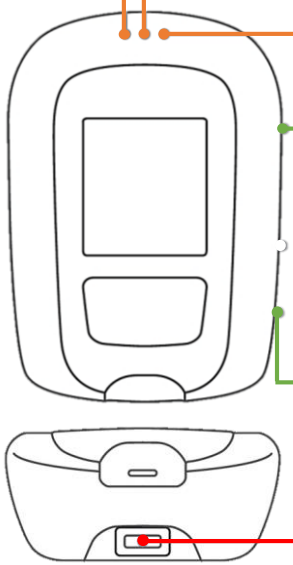

充電ランプ
充電時に点灯します
電池残量が少ないときに点滅します

転送ランプ
血糖値データ転送時に点滅します

エラーランプ
エラー発生時に点滅し、音が鳴ります
✔エラー音2回 / USBがつながっていない
✔エラー音3回 / アキュチェックガイドにデータがない
✔エラー音4回 / データが転送できていない

データ削除ボタン
削除ボタンと試験紙破棄ボタンを同時に2秒長押しで
アキュチェックガイドワンに残っている血糖値データ全て
を削除できます

試験紙廃棄ボタン
試験紙廃棄するときに押します
（同時にガイドモアへデータが転送されます）

充電USB
ガイドモアを充電するときに使います
✔ガイドモア、フル充電で約2000回のデータ転送
ができます

＊アキュチェックガイドワンおよびアキュチェックガイドストリップの添付文書と取扱説明書も併せて必ずお読みください

≪ ガイドモア 接続USB取外し方の注意点 ≫

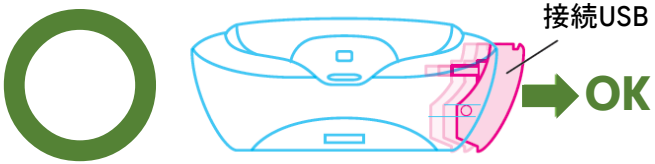

やさしく水平に引いてください

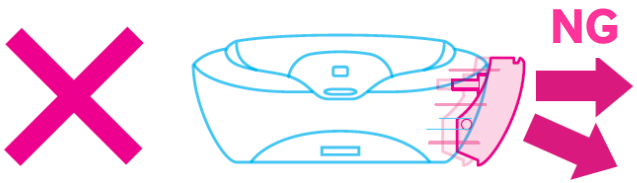

斜めに引っ張ったり 強く引っ張りすぎると
ストッパーが外れて破損してしまいます

≪ 電源がそれぞれ違います ≫

電池式

型番：CR2032

アキュチェックガイドワン

充電式

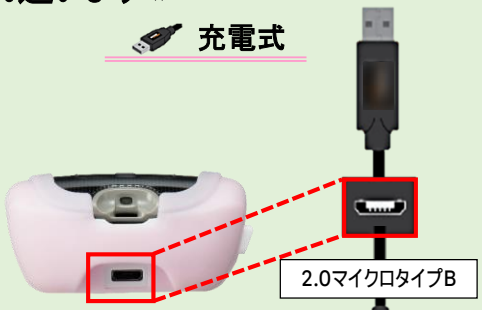

USBケーブルにて充電

ガイドモア

お問い合わせは下記の「ロシュにハロー お客様センター」へ

フリーダイヤル ロシュに ハロー
0120-642-860〈24時間 365日〉

ロシュDCジャパン株式会社

アキュチェックWebサイト http://www.accu-chek.jp

ACCU-CHEKはRocheの商標です。

©2022 Roche DC Japan K.K.3.0.RDC.A