カスタマーサポートおよびサービスセンター
ロシュにハローお客様センター
電話:0120-642-860

最終更新日: 2022-01

ロシュＤＣジャパン株式会社
東京都港区港南1-2-70
電話:0120-642-860
www.accu-chek.jp

ACCU-CHEK、ACCU-CHEK GUIDE、ACCU-CHEK GUIDE ME
およびアキュチェックはRocheの商標です。

© 2022 Roche Diabetes Care
09942602001-0322
09505946001A

ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK® Guide Me

Roche

自己検査用グルコース測定器

アキュチェック®ガイドMe クイックスタートガイド

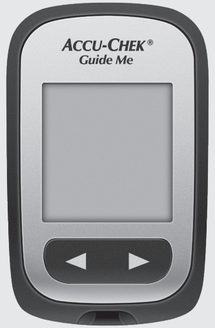

ACCU-CHEK®

概要

測定器:
アキュチェックガイドMe

1. 電源／決定ボタン
2. 画面
3. 左矢印ボタン ◀
4. 右矢印ボタン ▶
5. 試験紙差込口
6. 電池ボックスカバー
7. Micro-USBポート

試験紙:
アキュチェックガイドストリップ

8. 試験紙容器
9. 試験紙

*ご不明な点がございましたら、ロシュにハローお客様センター0120-642-860にお問い合わせください。

時刻および日付の設定

1



初めて測定器の電源をオンにすると、時刻および日付を設定するように指示するメッセージが表示されます。画面に**set-up**が表示され、時間が点滅します。

◀または▶を押して時間を増減します。

2



◉を押して時を確定し、分へ移動します。同様に日付も設定（注:日一月の順です）したら、試験紙記号が表示されるまで◉を**長押し**します。

⚠

このクイックスタートガイドは、添付文書や取扱説明書の代わりになるものではありません。添付文書や取扱説明書には、重要な取り扱い手順やその他の情報が記載されていますので、必ずお読みください。

Local Print/Pack
No PMS or PE approval.
No DM code or Mannheim PN.

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.

Roche USA – 83052
V4/1 – 09942602001 – Black

Roche USA – 83052
V4/2 – 09942602001 – Cyan

Roche USA – 83052
V4/3 – 09942602001 – Magenta

Roche USA – 83052
V4/4 – 09942602001 – Yellow

Approved according to SOP.04.07GPL.0004 **Production**
The Signature will not be printed!

LAN
IPM
PM/LAB
GD/LAY

血糖測定を行う

血糖測定を行う前に、流水で手を洗い、よく乾かします。

試験紙容器に記載の使用期限を確認します。使用期限の過ぎた試験紙は使用しないでください。

試験紙容器から試験紙を取り出し、フタをしっかりと閉めます。



試験紙の差し込み側（金属の部分）を測定器に差し込みます。



測定器の電源が自動で入ります。点滅するしずく記号が表示されます。



穿刺器具を使って採血します。穿刺器具を指にしっかりと押し当てながら、穿刺します。

試験紙の**黄色の先端部分**に血液をつけます。血液は試験紙の先端からつけてください。

画面に が表示されたら、試験紙から指先を離します。

血液のつけ方

⚠ 血液は試験紙の上からではなく、先端からつけてください。



⚠ 血液吸引部（黄色の先端部分）から吸引させてください。



4秒以内に測定結果が表示されます。

⚠

使用済みの試験紙およびランセットの廃棄については、お住まいの地区の自治体又は各医療機関等にお問い合わせください。

エラーコード一覧

メモ

エラーが発生すると、エラーコード（E-1からE 14）と**Err**が交互に画面に表示されます。

このような場合は取扱説明書を参照してください。

以下にエラーコードと内容を示します。

E-1 試験紙が破損しているか、適切に差し込まれていないか、使用済みです。試験紙を取り外して差し込み直すか、破損している場合または使用済みの場合は新しい試験紙を差し込みます。

E-3 測定器または試験紙にエラーが発生しました。このエラーメッセージは、試験紙が適切に保管または取り扱われなかったことにより、破損している可能性があります（例えば試験紙容器のキャップをしっかり閉じていなかった）。**エラーメッセージに基づいて治療に関する決定を行わないでください**。測定を再度行います。再びE-3エラーが表示された場合、コントロール液と新しい試験紙を使用して精度テストを実行します。取扱説明書の精度テストを行うの章の精度テストの手順を参照してください。E-3エラーが継続して表示される場合、予備の測定器や試験紙を使用するなど、別の方法で血糖測定を行ってください。別の方法による測定結果が極端に高い、または別の方法が利用できない場合には、**直ちに医師にご連絡ください**。まれに、測定結果が極端に高く、測定範囲を上回っている場合にE-3エラーが表示されることがあります。**取扱説明書の血糖測定の章の測定結果に疑問を感じたときの項を参照してください**。

E-4 血液またはコントロール液の量が少なすぎるか、測定が開始された後につけられました。試験紙を廃棄し、測定または精度テストを再度行います。

E-6 画面にしずく記号が点滅表示される前に、血液またはコントロール液が試験紙につけられました。試験紙を廃棄し、測定または精度テストを再度行います。

E-7 電子的なエラーが発生しました。電池を取り外し、電源／決定ボタンを2秒以上押してから、電池を入れ直します。測定または精度テストを再度行います。

E-8 温度が使用環境条件の範囲よりも高いか、低い状態です。使用環境条件については、測定器の添付文書を参照してください。使用環境条件の範囲内の温度の場所に移動し、測定または精度テストを再度実行します。測定器を人工的に加熱または冷却しないでください。

E-9 電池が消耗している可能性があります。測定器の電源を再度オンにします。**気温が低い場所にいる場合、使用環境条件の範囲内の温度の場所に移動します**。何度か再試行してもメッセージが表示される場合は、電池を交換してください。電池の交換後にメッセージが再び表示された場合、電池を取り外し、電源／決定ボタンを2秒以上押してから、電池を入れ直します。

E 10 時刻および日付の設定が正しくない可能性があります。測定器がペアリングされた機器と日時を同期している間、無線機号が点滅します。無線機号が消えたら、電源／決定ボタンを押して測定器の電源をオフにします。試験紙記号が点滅表示されるまで、再度電源／決定ボタンを押します。時刻および日付の同期が成功しなかった場合、次に測定器の電源をオンにしたときに時刻および日付の設定をするよう指示が表示されます。取扱説明書の新しいシステムの章の、時刻および日付の設定の項を参照してください。

E 11 試験紙が破損している可能性があります。新しい試験紙を使用して、血糖測定または精度テストを再度行います。

E 12 血液に高い濃度のアスコルビン酸が含まれている可能性があります。すみやかに医師の指示に従ってください。

E 13 試験紙差込口に液体または異物が入っている可能性があります。試験紙を取り外して差し込み直すか、新しい試験紙で測定または精度テストを再度行います。それでもエラーが解決しない場合にはロシュにハローお客様センターにお問い合わせください。

E 14 電子的なエラーが発生しました。「ロシュにハローお客様センター」にお問い合わせください。

メモ

繰り返しエラーが発生する場合、ロシュにハローお客様センター0120-642-860にお問い合わせください。

電池を交換する

測定器には、CR2032またはDL2032（メーカーによって名称が異なる場合があります）3Vコイン型リチウム電池2個を使用します。

注意
必ず予備の電池を常備してください。電池の寿命は、温度や電池の製造元などによって異なる可能性があります。

⚠

未使用および使用済みの電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。詳細については、取扱説明書を参照してください。



子どもが電池を誤飲するのを防ぐ設計の電池ボックスカバーは、ペンなど先の細いものを小さな溝（上図参照）に挿入し、てこの原理で押し上げて開けます。



使用済みの電池を取り外します。

＋（プラス）側を上に、新しい電池をツメの下にセットします。カバーを取り付け、カチッと音がするまで閉めます。使用済みの電池をすぐに廃棄してください。

ご不明な点がございましたら、ロシュにハローお客様センターにお問い合わせください。

フリーダイヤル　ロシュに　ハロー
0120-642-860
24時間365日