■薬剤等共存物質の影響

測定において、下記薬剤等に関して各濃度まで影響を受けないことを確認しています。

物質	濃度	物質	濃度	物質	濃度	物質	濃度
アカルボース	60 mg/dL	デキサメタゾン	1.2 mg/dL	ヒドロクロロチアジド	0.61 mg/dL	ピオグリタゾン	5 mg/dL
アスコルビン酸 *1	5 mg/dL	デキストロメトルファン	1 mg/dL	ヒドロコルチゾン	1 mg/dL	ピロキシカム	2.88 mg/dL
アセトアミノフェン	20 mg/dL	ジクロフェナク	5 mg/dL	DL-β-ヒドロキシ酪酸	100 mg/dL	ポリソルベート 80	24 mg/dL
アセタゾラミド	6 mg/dL	ジクマロール	20 mg/dL	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	4 mg/dL	塩化カリウム	50 mg/dL
アセトン	60 mg/dL	ジゴキシン	1 mg/dL	イバンドロン酸	0.5 mg/dL	プレドニゾロン	0.4 mg/dL
N-アセチル-L-システイン	20 mg/dL	ジルチアゼム	20 mg/dL	イブプロフェン	50 mg/dL	プリミドン	5 mg/dL
N-アセチルプロカインアミド	15 mg/dL	ジフェンヒドラミン	1 mg/dL	インドメタシン	5 mg/dL	プロベネシド	60 mg/dL
アセチルサリチル酸	60 mg/dL	ジピロン	11 mg/dL	インスリン	20 U/dL	プロカインアミド	10 mg/dL
アシクロビル	5 mg/dL	ジソピラミド	5 mg/dL	イソニアジド	5 mg/dL	プロプラノロール	1 mg/dL
アルブミン	5000 mg/dL	L-ドパ	2 mg/dL	カナマイシン	9 mg/dL	プソイドエフェドリン	1 mg/dL
アルブテロール	25 mg/dL	トリグリセライド *2	1800 mg/dL	乳酸	100 mg/dL	ピリジンアルドキシムメチオダイド（PAM）	25 mg/dL
アロプリノール	5 mg/dL	ドーパミン	0.09 mg/dL	ラクチトール	100 mg/dL	ピリドスチグミン	0.4 mg/dL
アミノカプロン酸	40 mg/dL	ドキサゾシン	1 mg/dL	乳糖	10 mg/dL	ピリドキシン	3 mg/dL
アミオダロン	5 mg/dL	ドキシサイクリン	3 mg/dL	レシチン	500 mg/dL	ピルビン酸	4 mg/dL
アミトリプチリン	1 mg/dL	EDTA 二カリウム	360 mg/dL	リドカイン	1.2 mg/dL	硫酸キニーネ	4.8 mg/dL
アモキサピン	0.1 mg/dL	EDTA ニナトリウムカルシウム	180 mg/dL	リシノプリル	1 mg/dL	ラミプリル	3.58 mg/dL
アモキシシリン	600 mg/dL	エナラプリル	8 mg/dL	ロラタジン	1 mg/dL	ラニチジン	20 mg/dL
アンピシリン	5.3 mg/dL	エフェドリン	1 mg/dL	ロバスタチン	0.4 mg/dL	レパグリニド	5 mg/dL
アステミゾール	1 mg/dL	エクイリン	15 mg/dL	硫酸マグネシウム	26 mg/dL	リファンピシン	8 mg/dL
アトルバスタチン	0.1 mg/dL	エリスロマイシン	60 mg/dL	マルチトール	20.2 mg/dL	ロシグリタゾン	5 mg/dL
アトロピン	1 mg/dL	エストラジオール	0.1 mg/dL	マルトース	360 mg/dL	サリチル酸	60 mg/dL
ベンセラジド	0.5 mg/dL	エストロン	1 mg/dL	D-マンニトール	600 mg/dL	重炭酸ナトリウム	336 mg/dL
胆汁酸	1.5 mg/dL	エタノール	350 mg/dL	D-マンノース	10 mg/dL	D- ソルビトール	70 mg/dL
ビリルビン（抱合型）	60 mg/dL	エトスクシミド	25 mg/dL	メタプロテレノール	1.81 mg/dL	ステアリン酸	15 mg/dL
ビリルビン（非抱合型）	60 mg/dL	アセト酢酸エチル	20 mg/dL	メトホルミン	50 mg/dL	ストレプトマイシン	15 mg/dL
ブスピロン	1 mg/dL	エチレングリコール	5 mg/dL	メチマゾール	0.25 mg/dL	スクロース	500 mg/dL
カフェイン	10 mg/dL	ファモチジン	0.6 mg/dL	メチルドパ	1.5 mg/dL	テルフェナジン	25 mg/dL
塩化カルシウム	20 mg/dL	フェロジピン	5 mg/dL	メドロキシプロゲステロン	50 mg/dL	テトラサイクリン	10 mg/dL
カプトプリル	0.5 mg/dL	フェノフィブラート	5 mg/dL	メトクロプラミド	0.5 mg/dL	テオフィリン	25 mg/dL
カルバマゼピン	3 mg/dL	フェノプロフェン	20 mg/dL	メトプロロール酒石酸塩	0.7 mg/dL	チオリダジン	4 mg/dL
ベータカロチン	0.6 mg/dL	フレカイニド	1 mg/dL	メキシレチン	1 mg/dL	L- チロキシン	5 mg/dL
セファクロル	200 mg/dL	5-フルオロシトシン	30 mg/dL	ミソプロストール	0.8 mg/dL	トブラマイシン	3.6 mg/dL
セファドロキシル	10.5 mg/dL	フルオキセチン	12 mg/dL	ナドロール	2 mg/dL	トラザミド	200 mg/dL
セフトリアキソン	100 mg/dL	フルルビプロフェン	5 mg/dL	ナプロキセン	100 mg/dL	トルブタミド	100 mg/dL
セファレキシン	32 mg/dL	フルチカゾン	0.1 mg/dL	臭化ネオスチグミン	0.2 mg/dL	トラゾドン	2 mg/dL
セファロチン	200 mg/dL	フルクトース	250 mg/dL	ニコチン	2 mg/dL	トリアムテレン	6 mg/dL
セチリジン	1 mg/dL	フロセミド	6 mg/dL	ニフェジピン	40 mg/dL	トリメトプリム	6 mg/dL
ケノデオキシコール酸	3 mg/dL	ガラクトース	300 mg/dL	ニトロフラントイン	4 mg/dL	DL-チロシン	24 mg/dL
クロロチアジド	2.7 mg/dL	ガラクトース-1-リン酸	5 mg/dL	ノルドキセピン	5 mg/dL	尿素	600 mg/dL
クロルプロパミド	80 mg/dL	ガンマグロブリン	3000 mg/dL	D-ノルプロポキシフェン	1 mg/dL	尿酸	23.5 mg/dL
コレステロール	500 mg/dL	ゲムフィブロジル	15 mg/dL	ノルトリプチリン	0.3 mg/dL	バルプロ酸	50 mg/dL
コール酸	2.4 mg/dL	ゲンタマイシン	3.6 mg/dL	ノルベラパミル	1 mg/dL	バンコマイシン	20 mg/dL
シメチジン	10 mg/dL	ゲンチジン酸	1.8 mg/dL	オレイン酸	35 mg/dL	ベラパミル	1 mg/dL
シタロプラム	0.6 mg/dL	グリメピリド	1 mg/dL	オメプラゾール	0.52 mg/dL	ビタミン B12	1 mg/dL
クエン酸	30 mg/dL	グリピジド	8 mg/dL	シュウ酸	20 mg/dL	ビタミン E	20 mg/dL
クリンダマイシン	4.5 mg/dL	グルコサミン	450 mg/dL	パルミチン酸	150 mg/dL	ボルベン	800 mg/dL
クロニジン	2 mg/dL	グルタチオン (還元型)	6.14 mg/dL	D-ペニシラミン	2.4 mg/dL	ワルファリン	10 mg/dL
クレアチニン	30 mg/dL	グリベンクラミド	1.5 mg/dL	ペニシリン G	15 mg/dL	キシリトール	200 mg/dL
シクロホスファミド	37.5 mg/dL	グリセロール	10 mg/dL	フェネルジン	0.5 mg/dL	キシロース *3	10 mg/dL
L-システイン	5 mg/dL	ヘモグロビン	10 g/L	L-フェニルアラニン	50 mg/dL	プロポフォール	4.8 mg/dL
L-シスチン	50 mg/dL	ヘパリン（Li）	8000 U/dL	フェニトイン	10 mg/dL		
デシプラミン	0.1 mg/dL	ヘパリン（Na）	8000 U/dL	ピンドロール	0.5 mg/dL		

＊1 アスコルビン酸の静脈内注射中は測定しないでください。　＊2 トリグリセライドは 1,800 mg/dL まで測定に影響ありません。　＊社内データ
＊3 キシロース吸収試験中は測定しないでください。

24372_101121

@2021.Roche DC Japan.K.K.11.0.GUY.A

使用上の注意点

■血糖測定を行う前に、組み合わせて使用する製品を必ずご確認ください。
■個装箱開封後は、試験紙容器の製品名を必ずご確認ください。

アキュチェックガイドワン

アキュチェックガイドワン
ストリップ

アキュチェックガイド

アキュチェックガイド
ストリップ

[アキュチェックガイドワン]　一般医療機器、特定保守管理医療機器／届出番号　13B1X10225000007
[アキュチェックガイドワンストリップ]体外診断用医薬品／届出番号　13E1X00005000001
[アキュチェックガイド]　高度管理医療機器、特定保守管理医療機器／認証番号　229AABZX00011000
[アキュチェックガイドストリップ]体外診断用医薬品／承認番号　22900EZX00001000

お問い合わせは下記の「ロシュにハロー お客様センター」へ

フリーダイヤル　ロシュに　ハロー
0120-642-860〈24時間365日〉

ACCU-CHEK® Guide One

アキュチェックガイドワン測定方法

■血糖値測定方法

＊添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。

1

試験紙容器から試験紙を取り出し、フタをしっかりと閉めます。

2

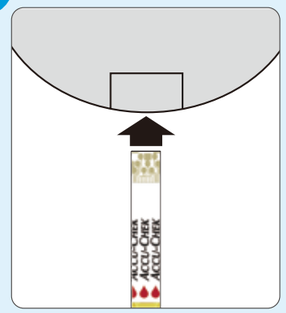

試験紙の差し込み側（金属の部分）を測定器に差し込みます。

3

測定器の電源が入り、「血液をつける」と表示されます。

4

試験紙の血液吸引部に血液をつけます。「測定中」と表示されたら、試験紙から指を離します。

5

測定結果が画面に表示されます。

6

測定器側面の試験紙廃棄ボタンを押して、使用済みの試験紙を取り外して廃棄します。

■穿刺器具（アキュチェック セミディスポ）の操作方法

1

針の深さを調節します。

2

針をセットします。

ランセットの取りつけ方向

3

穿刺ボタンを押して穿刺します。

4

取り外しボタンを押して針を廃棄します。

使用前

使用後

使用後はインナーガイド（薄紫色の部分）が前方に移動します。

使用済みの試験紙や針の廃棄方法については、お住まいの地区の自治体又は各医療機関等にお問い合わせください。

血液のつけ方

⚠ 血液は試験紙の上ではなく先端からつけてください。



⚠ 血液吸引部（黄色の先端部分）がすべて赤くなるまで吸引させてください。

［アキュチェック セミディスポ］一般医療機器／届出番号　33B2X00002000005
［アキュチェック セミディスポ ランセット］管理医療機器／認証番号　224AFBZX00050000

アキュチェックWebサイト http://www.accu-chek.jp/

ACCU-CHEKはRocheの商標です。

お問い合わせは下記の「ロシュにハロー お客様センター」へ

フリーダイヤル 0120-642-860 ロシュに ハロー 〈24時間365日〉

ロシュDCジャパン株式会社