Accu-Chek® Mobile アキュチェックモバイル
正しい測定操作法

誤った操作法は実際とは異なる測定結果につながる可能性があり、この測定結果は適切でない治療につながる恐れもあります。そのため、正しい測定結果が得られるよう、次の手順に従い操作を行なってください。

	行なっていただきたい事	避けていただきたい事	理由	
1	指先からの採血をする場合は、穿刺前に必ず流水で手を洗い、じゅうぶんに乾かしてください。	手を洗わずに、指が**汚れていたり、**（たとえば、食べ物や飲み物が付着して）**べたつきがある**ままでの測定は避けてください。	手を洗わずに、汚れた指やべたつきのある指で測定すると、実際の値よりも高い血糖値を示す事があり、その測定結果を元にインスリンの単位の調整を行なう場合、インスリンを多く打ってしまう可能性があります。	1
2	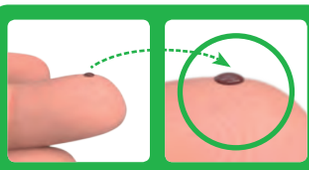 血液をじゅうぶんな大きさでしっかりした球状にします。	球状にならずに**広がった血液は点着しない**でください。 測定エリアを指に押し付けて、球状の**血液を広げない**でください。	広がった血液や測定エリアで押し広げるように点着した場合、汚れ等により実際の値よりも高い血糖値を示す事があり、その測定結果を元にインスリンの単位の調整を行なう場合、インスリンを多く打ってしまう可能性があります。	2
3	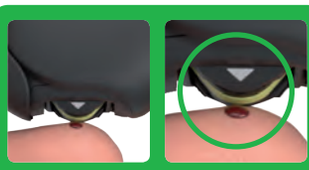 球状の血液を測定エリアの中央に軽くつけます。	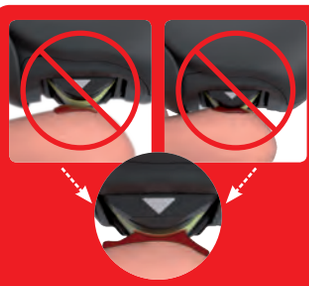 測定エリアに指を**強く押しつけたり、**測定器を**揺らしながら**測定する事は避けてください。	測定エリアに指を押しつけると実際の値よりも高い血糖値を示す事があり、その測定結果を元にインスリンの単位の調整を行なう場合、インスリンを多く打ってしまう可能性があります。	3
4	採血後は、速やかに測定エリアに点着し、「測定中」の画面が出てきたら（*もしくはピーという確認音が鳴ったら）指を離してください。 *確認音が鳴るのは設定をオンにしている場合です。詳しくは取扱説明書をご参照ください。 	採血後、時間をおいた血液で測定しないでください。 画面に「測定中」が表示されたら、（もしくはピーという確認音が鳴ったら）それ以上は**測定エリアに指を付けたままにしない**でください。	時間をおいて測定した場合、血液の濃縮により実際の値よりも高い血糖値を示す事があり、その測定結果を元にインスリンの単位の調整を行なう場合、インスリンを多く打ってしまう可能性があります。 指を離すタイミングは、確認音を使用するとわかりやすくなります。	4

ACCU-CHEK および ACCU-CHEK MOBILE は、Roche の商標です。
© 2014 Roche Diagnostics
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
〒105-0014 東京都港区芝2-6-1
フリーダイヤル：0120-642-860
アキュチェックWeb サイト： www.accu-chek.jp/

Roche Diagnostics GmbH
68305 Mannheim, Sandhofer Str. 116, Germany

ACCU-CHEK®

Roche

07300000001(01)
V4/R0 – 2014-05
M_Version01_Rev1

0 7310269 001-A