ACCU-CHEK® Guide Link

〈アキュチェックガイドLinkを用いた血糖測定と値の送信方法〉

＊血糖測定を行う前に、必ず流水で手をよく洗い、十分に乾かしてください。

操作方法を動画でチェック

血糖値の測定方法

ポンプへの血糖値の送信方法

Roche

1. 試験紙を1枚取り出し、すぐ閉める

2. 試験紙をセットする

3. 「血液をつける」と表示されたことを確認する

4. 穿刺（せんし）する

5. 血液をつける

血液のつけ方

血液は試験紙の上ではなく先端からつけてください。



血液吸引部（黄色の先端部分）から吸引させてください。

6. 結果を確認する

測定範囲：10〜600 mg/dL

7. 試験紙のあとかたづけ

8. 値をポンプに送信する

9. ポンプ画面で値を確認する

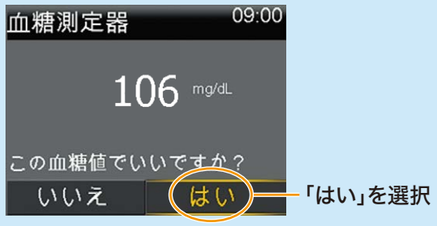

・転送した値は12分間表示されます。
・転送された血糖値を表示するにはポンプをホーム画面にします。

10. 次の操作を選択する

転送した値を用いて下記より次に行う操作を選択します。

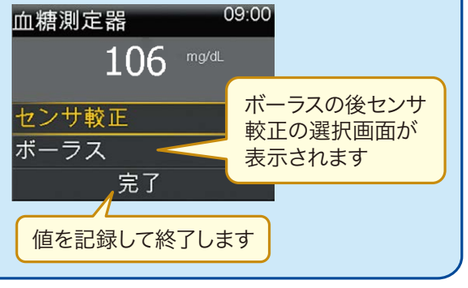

使用済みの試験紙やランセットの廃棄方法については、お住まいの地区の自治体または各医療機関等にお問い合わせください。

＊ご使用前に添付文書または電子添文と取扱説明書を必ず読んでください。

アキュチェックガイド Link および アキュチェックガイドストリップに関するお問い合わせ

ロシュDCジャパン株式会社

「ロシュにハロー お客様センター」へ 24時間365日 フリーダイヤル ロシュに ハロー 0120-642-860

ミニメド770Gインスリンポンプに関するお問い合わせは
日本メドトロニック24時間サポートラインへ 0120-56-32-56（24時間365日）

血糖測定に必要なもの

■測定器：アキュチェックガイドLink

■試験紙：アキュチェックガイドストリップ

■穿刺器具　■ランセット

■アルコール綿／ティッシュペーパーなどは必要に応じてご自身でご用意ください。

※Micro-USBポートを使用したデータ転送や充電等は行えません。

電池の交換

未使用および使用済みの電池はお子様の手の届かない場所に保管してください。



画面にE-9のエラーメッセージが表示されたら、電池の交換時期です。

アキュチェックガイドLinkに使用する電池は **CR2032** 2個です。

弊社では Panasonic（パナソニック）の電池を使用しています。

1



ペンなど先の細いものを小さな溝に挿入し、子供用安全設計の電池ボックスカバーを開けます。矢印方向にツメを押して、電池ボックスカバーを押し上げます。

2



ボタンを押して、使用済みの電池を取り出します。測定器の表面の電源／OKボタンを2秒以上長押しします。

3



(+)側を上向きにして、新しい電池を黒色のツメとボタンの下にスライドさせます。電池ボックスカバーを元の位置に取り付け、カチッと音がするまで閉めます。

ミニメド™ 770G インスリンポンプとのペアリング方法

以下の手順で、血糖自己測定器 **アキュチェックガイドLink**と **ミニメド™ 770Gインスリンポンプ** をペアリングしてください。

操作方法を動画でチェック

1 アキュチェックガイド Link の **OK** ボタンを押し、測定器をオンにします。

2 **設定**を選択します。

3 **無線**を選択します。

4 確認画面が表示されたら、**はい**を選択します。



アキュチェックガイド Link のシリアル番号が画画に表示されます。

シリアル番号は測定器毎に異なります。

これで**測定器の準備**が完了しました。
続いてポンプを操作します。

5 ポンプの◎ボタンを押し、オプション→ユーティリティ→接続機器オプション→**機器のペアリング**の順に選択します。

6 **検索**を選択します。



◎ボタン
- ホーム画面で◎を押すとメニューが表示されます。
- ◎で選択したメニューを確定します

7 アキュチェックガイド Link の画面に表示されたシリアル番号と一致する測定器を選択します。

8 ポンプに表示されているシリアル番号とアキュチェックガイド Link の画面のものが一致したら、**確認**を選択します。



ポンプに「ペアリング成功」のメッセージが表示されます。アキュチェックガイド Link の画面に、「ペアリング完了」のメッセージと「ポンプのシリアル番号」が表示されれば完了です。

※製品の仕様、外観、パッケージ、画面等は予告なく変更することがあります。

[アキュチェックガイドLink]
高度管理医療機器／特定保守管理医療機器／認証番号：302AABZX00094000
[アキュチェックガイドストリップ]
体外診断用医薬品／承認番号：22900EZX00001000
[メドトロニック ミニメド 700シリーズ]
高度管理医療機器／特定保守管理医療機器／承認番号：30300BZX00256000

アキュチェックWebサイト
http://www.accu-chek.jp/

ACCU-CHEK、ACCU-CHEK GUIDE およびアキュチェックは Roche の商標です。
メドトロニックは、Medtronic の商標です。

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.,and any use of such marks by Roche is under license. All other product names and trademarks are the property of their respective owners.

©2023 Roche DC Japan K.K.XX.XXXX.GUY.A